

D:O Ortho
NAVI
DIO Web Site
Order Manual Ver. KOR

Full Digital Ortho Solution




1



회원가입 / 로그인



2

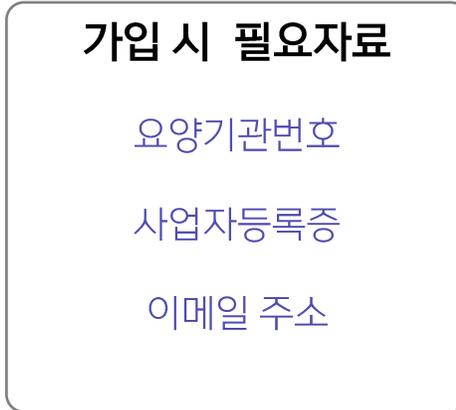


3

영업사원 문의 / 거래처 등록



DIO Ortho NAVI 주문

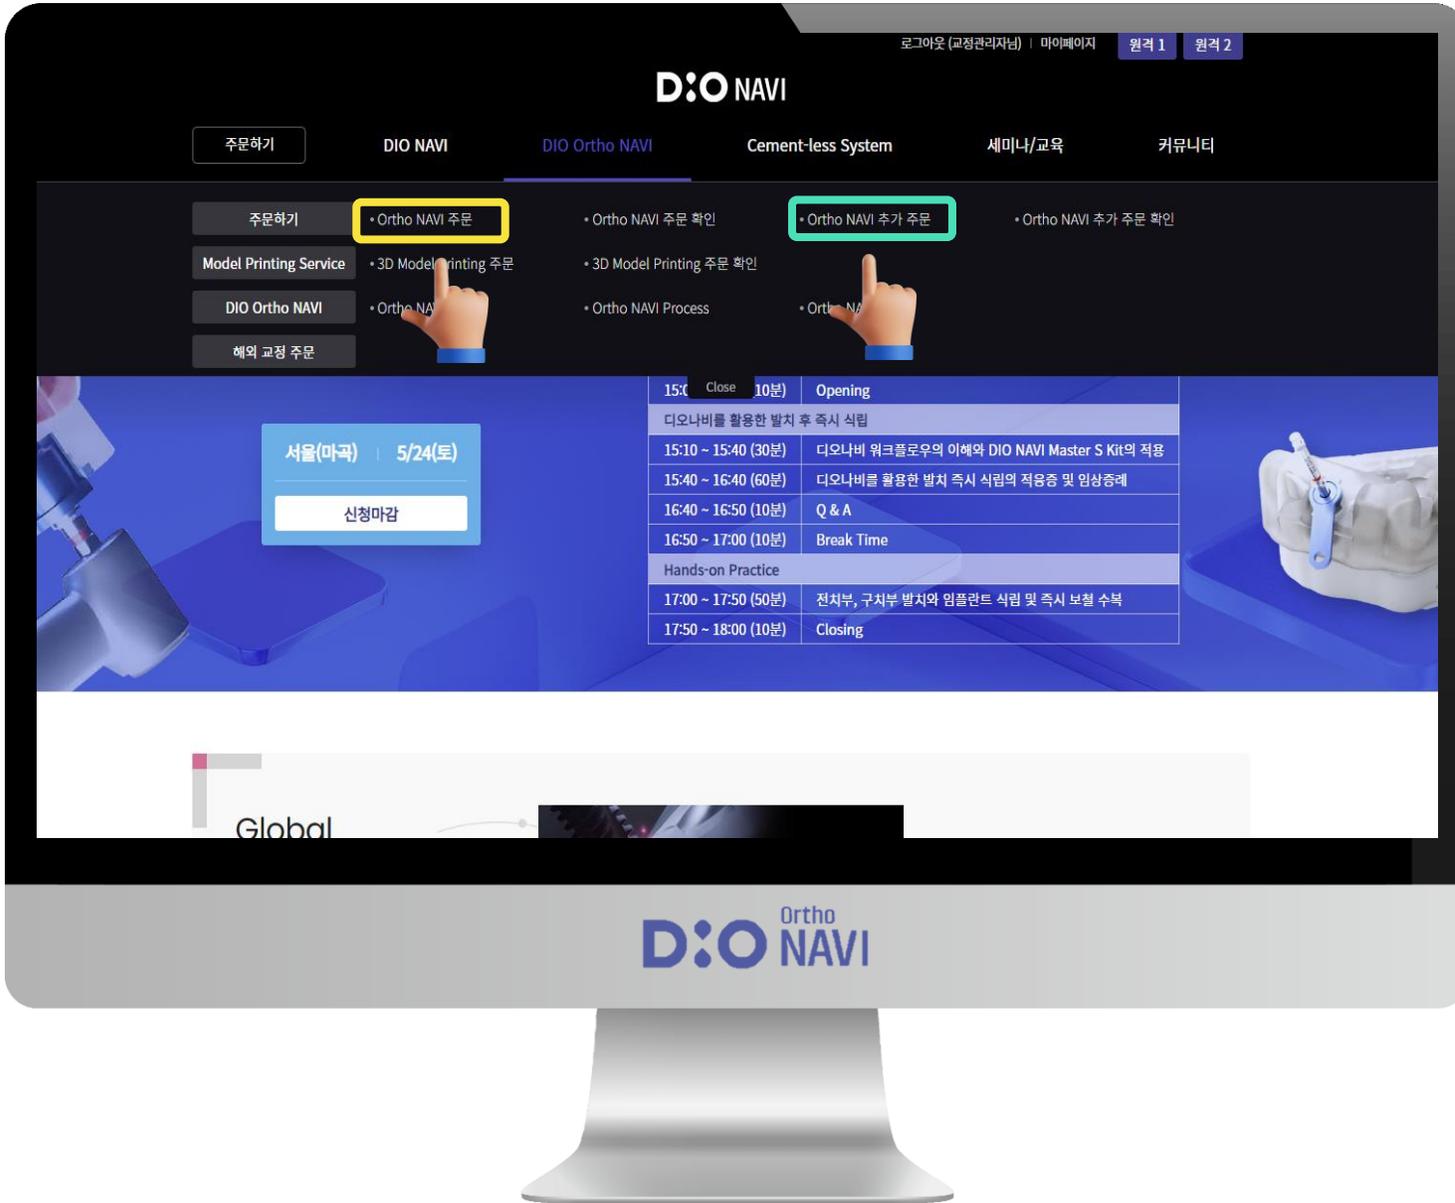

● 첫 주문

- Ortho NAVI. 주문
-신규 Case의 주문서 작성
- Ortho NAVI. 주문확인
-신규 Case 진행상태 및 Set-up 확인

● 진행 중인 Case 확인 및 추가 주문이 필요한 경우

- DIO Ortho NAVI. 추가 주문
-진행 중인 Case 추가 주문 접수 가능
- DIO Ortho NAVI. 추가 주문 확인
-추가주문 진행상태 및 Set-up 확인

DIO Ortho navi 주문

1 DIO Ortho navi. 클릭

로그아웃 (고정관리자님) | 마이페이지 | 원격 1 | 원격 2

DIO NAVI

주문하기 | DIO NAVI | **DIO Ortho NAVI** | Cement-less System | 세미나/교육 | 커뮤니티

주문하기 | • Ortho NAVI 주문 | • Ortho NAVI 주문 확인 | • Ortho NAVI 추가 주문 | • Ortho NAVI 추가 주문 확인

Model Printing Service | • 3D Model Printing 주문 | • 3D Model Printing 주문 확인

DIO Ortho NAVI | • Ortho NAVI란 | • Ortho NAVI Process | • Ortho NAVI 임상

해외 교정 주문

서울(미국) | 5/24(토)

신청마감

15x	Close	10분	Opening
디오나비를 활용한 발치 후 즉시 식립			
15:10 ~ 15:40 (30분)	디오나비 워크플로우의 이해와 DIO NAVI Master S Kit의 적용		
15:40 ~ 16:40 (60분)	디오나비를 활용한 발치 즉시 식립의 적응증 및 임상중재		
16:40 ~ 16:50 (10분)	Q & A		
16:50 ~ 17:00 (10분)	Break Time		
Hands-on Practice			
17:00 ~ 17:50 (50분)	전치부, 구치부 발치와 임플란트 식립 및 즉시 보철 수복		
17:50 ~ 18:00 (10분)	Closing		



2 DIO Ortho navi. 주문

로그아웃 (고정관리자님) | 마이페이지 | 원격 1 | 원격 2

DIO NAVI

주문하기 | DIO NAVI | DIO Ortho NAVI | Cement-less System | 세미나/교육 | 커뮤니티

주문하기 | • **Ortho NAVI 주문** | • Ortho NAVI 주문 확인 | • Ortho NAVI 추가 주문 | • Ortho NAVI 추가 주문 확인

Model Printing Service | • 3D Model Printing 주문 | • 3D Model Printing 주문 확인

DIO Ortho NAVI | • Ortho NAVI란 | • Ortho NAVI Process | • Ortho NAVI 임상

해외 교정 주문

서울(미국) | 5/24(토)

신청마감

15x	Close	10분	Opening
디오나비를 활용한 발치 후 즉시 식립			
15:10 ~ 15:40 (30분)	디오나비 워크플로우의 이해와 DIO NAVI Master S Kit의 적용		
15:40 ~ 16:40 (60분)	디오나비를 활용한 발치 즉시 식립의 적응증 및 임상중재		
16:40 ~ 16:50 (10분)	Q & A		
16:50 ~ 17:00 (10분)	Break Time		
Hands-on Practice			
17:00 ~ 17:50 (50분)	전치부, 구치부 발치와 임플란트 식립 및 즉시 보철 수복		
17:50 ~ 18:00 (10분)	Closing		



* 진행 중인 Case 확인 및 추가 주문이 필요한 경우

- DIO Ortho NAVI. **추가 주문 / 진행 중인 Case 추가적 주문 접수 ***
- DIO Ortho NAVI. **추가 주문 확인 / 진행 중인 Case 추가 주문 확인**

DIO Ortho navi 주문 1

DIO Ortho navi. 주문

홈 > DIO Ortho navi. > 주문하기 > DIO Ortho navi. 주문

작성시에 주의해주세요!

- 1 DIO Ortho navi. 주문시 Chrome에서 사용하실 것 권장드립니다.
- 2 주문정보에서 치료 약공까지는 입력을 하셔야 사진 저장 및 임시 저장이 가능합니다.

01 치과정보

* 표시는 필수 입력항목입니다.

치과명/가공소(선택) *	교정관리자		
배송지 정보 *	배송지를 선택하세요!!! 배송메세지를 입력해주세요.		
회원 기본정보 연락처	원장님	전화번호	이메일
	실장님	전화번호	이메일
	디오나비 담당스텝	전화번호	이메일
주문 담당 연락처/이메일 *	1	1	1
	담당자2	전화번호2	이메일2
	담당자3	전화번호3	이메일3
영업담당자 연락처/이메일 *	영업담당자	영업담당 전화번호	영업담당 이메일
임상담당자	설재운	010-9074-7142	jaeyoon0606@dio.co.kr

※ 해당 항목은 마이페이지 > 정보수정 에서 변경이 가능합니다.
 ※ 휴대폰번호/이메일 정보 변경 시, 진행중인 주문건에 대해서도 변경된 정보로 SMS와 이메일이 발송됩니다.
 ※ 담당자 정보로 SMS와 이메일이 발송됩니다. 정확한 정보를 입력해주세요.



01 치과정보 기입

* 필수입력

Step1 배송지 정보 선택 (마이페이지 연동)



Step2 회원 기본정보 연락처 (마이페이지 연동)



Step3 주문 담당 연락처 ▶ 교정 담당 선생님



DIO Ortho navi 주문 2

주문 담당 연락처/이메일 *	1	1	1
	담당자2	전화번호2	이메일2
	담당자3	전화번호3	이메일3
※ 담당자 정보로 SMS와 이메일이 발송됩니다. 정확한 정보를 입력해주세요.			
영업담당자 연락처/이메일 *	영업담당자	영업담당 전화번호	영업담당 이메일
임상담당자	설재운	010-9074-7142	jaeyoon0606@dlo.co.kr

02 환자기본정보

* 표시는 필수 입력항목입니다.

환자 이름 *	<input type="text"/>
생년월일 *	YYYY년 MM월 DD일 환자 성별 <input type="radio"/> 남자 <input type="radio"/> 여자

03 주문정보

* 표시는 필수 입력항목입니다.

Scan File *	<input type="radio"/> Trios Scan <input type="radio"/> Medit Scan <input type="radio"/> 석고모델 <input type="radio"/> 기타
치료 약궁 *	<input type="radio"/> 양악 <input type="radio"/> 상악 <input type="radio"/> 하악 (치료 약궁까지는 입력을 하셔야 사진 저장 및 임시 저장이 가능합니다.)
장치 종류 *	<input type="radio"/>  손축 <input type="radio"/> 설축 <input type="radio"/> 투명교정 <input type="radio"/>  손축 <input type="radio"/> 설축 <input type="radio"/> 투명교정
치료 범위 *	<input type="radio"/>  부분교정 <input type="radio"/> 전체교정 <input type="radio"/> 부분교정 플러스(+) <input type="radio"/> 전체교정 플러스(+)

Ortho
D:O NAVI

02 환자정보 기입

* 필수입력

환자이름 / 생년월일 / 환자 성별 기입



03-1 주문정보 기입

* 필수입력

- Scan File *

Trios ▶ DIO Ortho NAVI. 연구소 연결

Medit ▶ Medi Link / 파트너 연결, DIO Ortho NAVI. 검색

석고모델 ▶ Scan Fee / 1만원 적용, Scan 대비 +2일

석고 모델 주문시 확인하세요!

교정 석고 모델 주문 시 주의하세요!

교정 Scan 금액: ※ 2023년 1월부터 디오·비와 동일하게 석고모델에 대한 Scan Fee(10,000원)가 적용됩니다. ※ 석고 모델 보존기간은 3개월입니다. 이후에는 석고 모델이 깨기될수 있습니다.

제작기간: 석고 모델 주문 접수 시 Trios 대비 +2일 소요 (주말 및 공휴일 제외) 의뢰 받은 날로부터 제작기간 2박 3일

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일
	Trios	입수/전필요성 및 확인	전필요성	발송				
	석고모델	입수/전필요성 및 확인	전필요성	발송				

발송(제품 출고): 전필요 확인 날로부터 +3일 (전필요 확인이 늦으면 발송일이 늘어납니다.)

제품 수령: 발송일 1~2일 이후

석고 모델 발송시: 디오 문서로 석고 모델 발송 시, 포장 박스 외관에 '교정용' 문구 표시 후 발송해주세요. 표시가 없는 석고 모델은 택배 분리가 어려울 수 있습니다.

[배송지]: 부산 부산광역시 해운대구 연립서로56 디오 임플란트 6층 교정팀(본사)
서울 서울특별시 강서구 마곡중앙로 41 디오 R&D 센터 5층 교정팀

빠른 학습을 위해 '교정용' 문구 표시 후 발송해주세요.

기타 ▶ 선택 아이콘 제외한 Scan File 업로드 가능

Scan File Upload (기타일 경우) * 선택된 파일 없음

※ 압축파일 또는 STL 파일만 업로드가 가능하며 파일은 1개만 업로드가 가능합니다.

- 스캔 파일 압축 시 (상악/하악/교합) 3가지 파일 필수로 포함 되어야 합니다.



03-2 주문정보 기입

* 필수입력

- **치료 약궁 ***

양악 상악 하악

➔ 편악을 선택하는 경우

대합치 교정유무 * 원내에서 교정 교정하지 않음 DIO plan에 따름

DIO plan에 따름 : 양악 교정을 추천 할 가능성이 있습니다.

- **장치 종류 / 치료범위 / 투명장치 Stage ***


순측 부분교정 전체교정 부분교정+ 전체교정+

설측 부분교정 부분교정+

투명교정 Express Lite Enough Comprehensive

Teen 유지장치 기타

* 최초의 선택은 Set-up후 변경 될 수 있습니다.

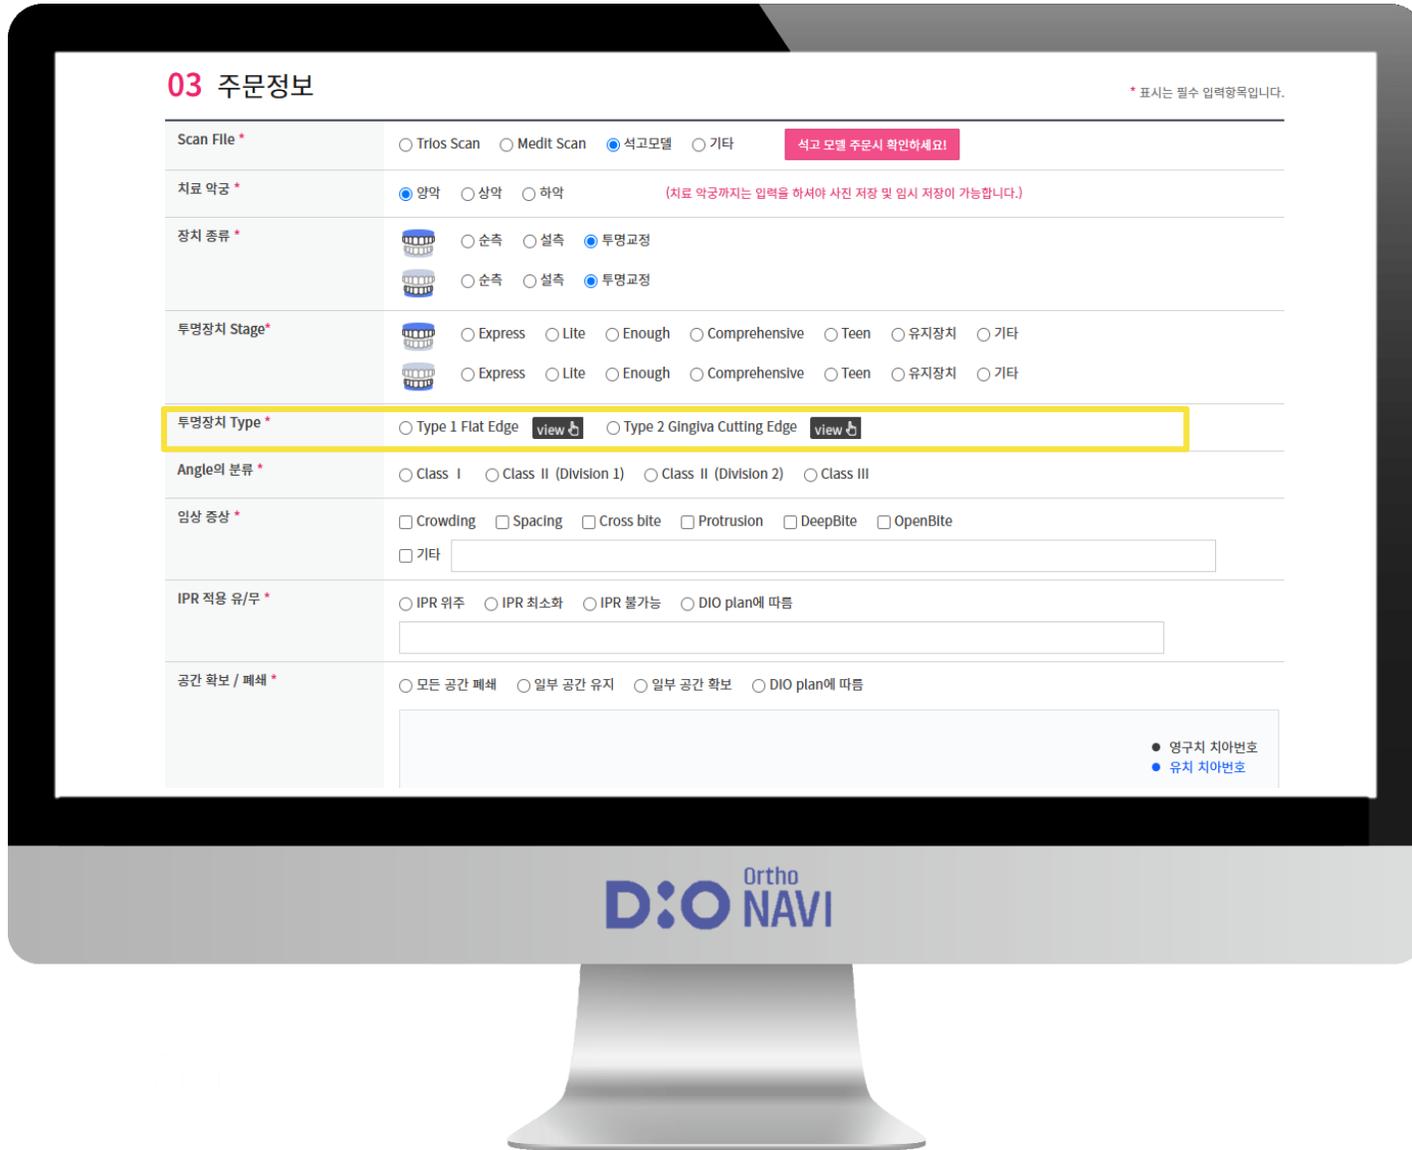

03-3 주문정보 기입

* 필수입력

- 투명장치 Type *

- Type 1 Flat Edge



- Type 2 Gingiva Cutting Edge





03-4 주문정보 기입


* 필수입력

- Angle의 분류*

- Class I Class II (Division 1)
- Class II (Division 2) Class III

- 임상증상* (중복선택 가능합니다.)

- Crowding Spacing Protrusion
- Deep Bite Open Bite
- 기타 (자세하게 기입)

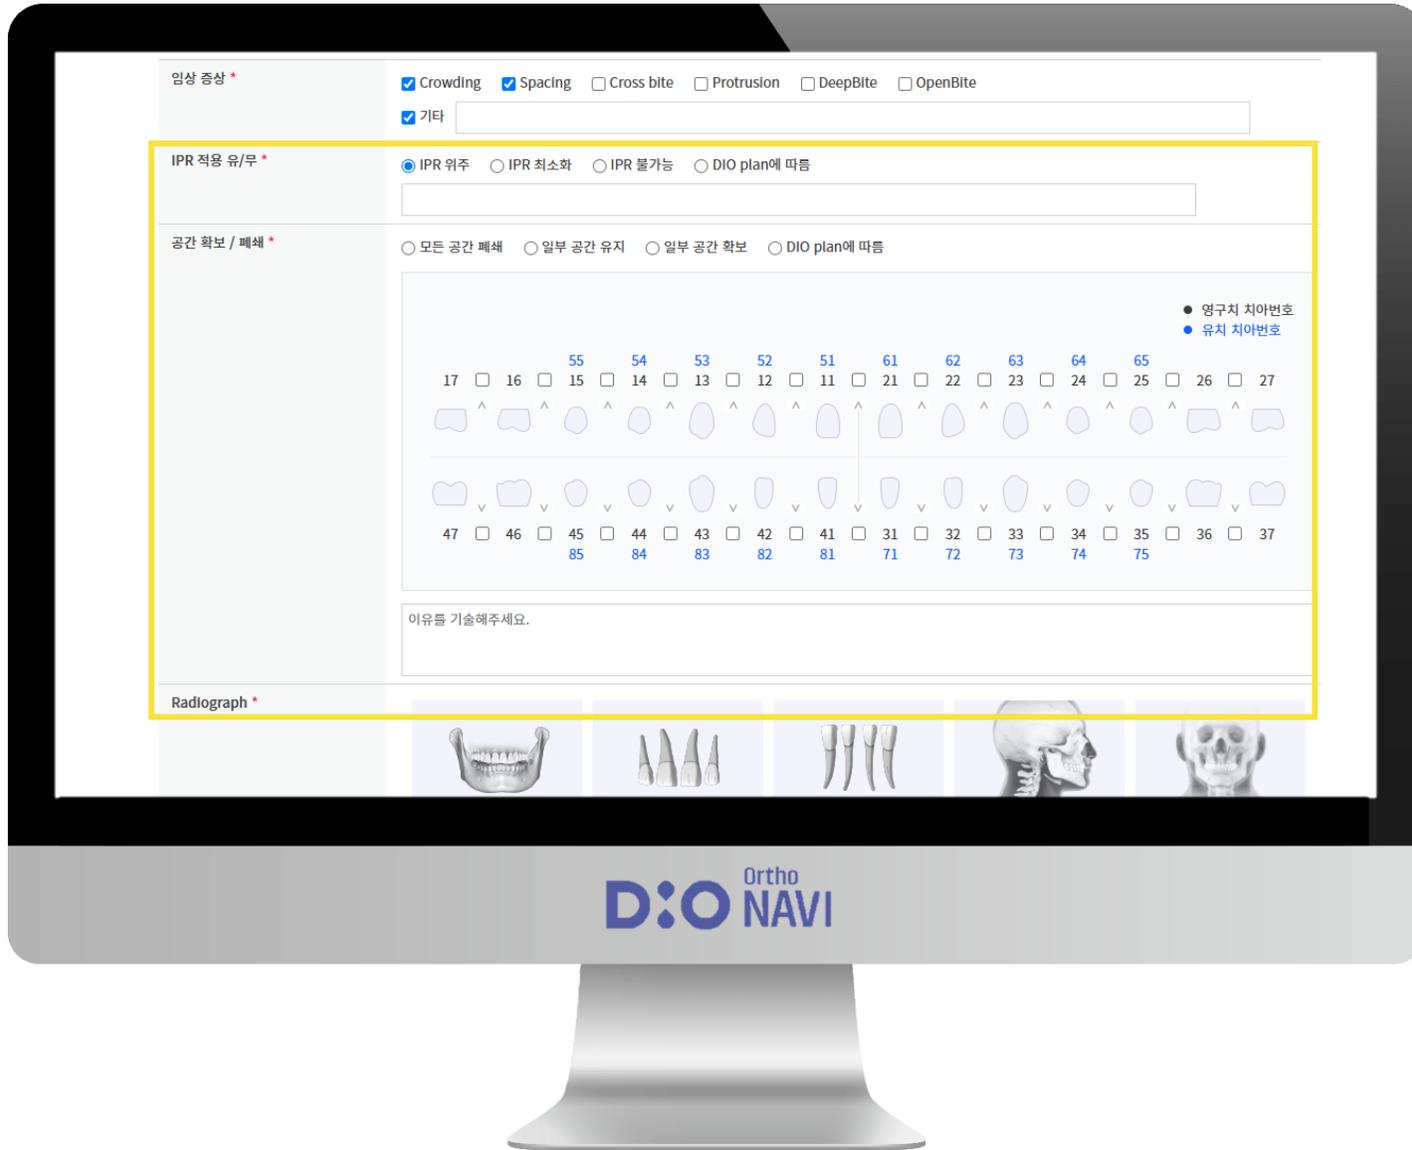

03-5 주문정보 기입

* 필수입력

- IPR 적용 유/무 *

○ IPR 위주 ○ IPR 최소화 ○ IPR 불가능 ○ DIO plan에 따름

➔ IPR 최소화 선택 시 이유기재

- 공간 확보/폐쇄 * (4가지 선택 사항)

○ 모든 공간 폐쇄 남아있는 공간 부위에 체크 후 기입 해 주세요.



○ 일부 공간 유지 일부 공간을 유지 할 부위를 체크 해 주세요.



○ 일부 공간 확보 공간 확보 부위 체크 후 mm수 기입 해 주세요.



○ DIO plan에 따름 치료계획 또는 특이사항 기입 해 주세요.

➔ 치료계획 Ex1) #14,24 Implant / Ex2) #13-#23 br.



03-6 진단자료 첨부

* 필수입력

- 방사선사진 *   사진 방향 조절 가능
 1. Panorama
 2. 상악 전치부ST
 3. 하악 전치부ST
 4. Cep Lat
 5. Cep PA
 6. CT Ortho NAVI팀에서 CT파일 요청 시 [ortho@dio.co.kr]로 보내주세요.
 CT파일 전송 유/무(메일 전송 했을 시 체크 해 주세요.)
- 구외사진 *
 1. 정면
 2. 45°측면
 3. 90°측면
 4. Smile line
- 구내사진 *
 1. 상악 교합면
 2. 하악 교합면
 3. 정면
 4. 교합 시 좌측 측면
 5. 교합 시 우측 측면
 6. 2cm 개구 시 정면 (과개교합의 경우 필수)



03-7 특별 주문 사항 / 쿠폰 코드

- 특별 주문 사항 입력 (치료계획 내용 입력 / 파일 첨부 가능)

위 주문내용 외 별도의 요청사항을 기재 부탁드립니다.
(주문내용 외 별도의 Set-up 요청사항 입력)

파일 첨부 가능

- 쿠폰코드 입력 (쿠폰이 있는 경우 사용가능)

편약 : 1 장 / 양약 : 2장 ex) orthonavi 1023

orthonavi 1023

Code No. orthonavi1023

Code No. orthonavi1023

디지털 교정
50% 할인권


발행일 : 20

본 할인권은 정기결제에서 50% 할인금액에 적용되며 발행일로부터 1년 이내 사용 가능합니다.



쿠폰 샘플

*본 할인권은 정기결제에서 50% 할인금액에 적용되며 발행일로부터 1년 이내 사용 가능합니다.
 *본 할인권은 정기결제에서 50% 할인금액에 적용되며 발행일로부터 1년 이내 사용 가능합니다.

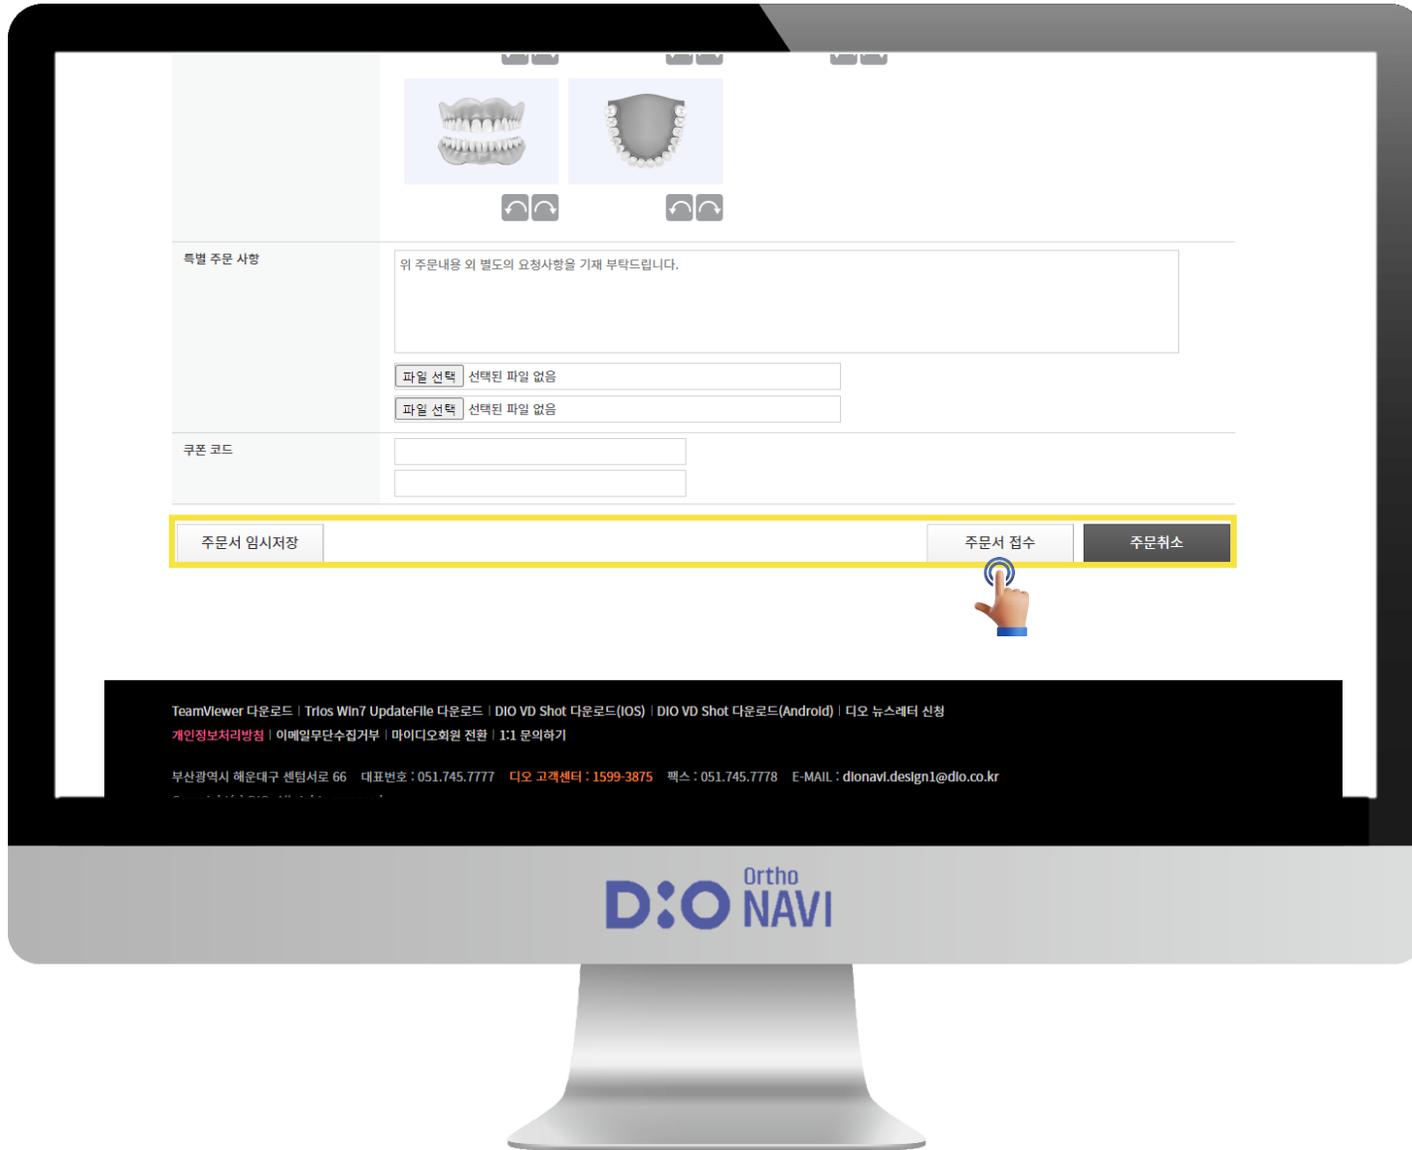

04 주문서 접수

주문서 임시저장

주문서 임시저장 할 경우 “주문 임시저장”에서 확인 가능합니다.

DIO Ortho navi. 주문 확인

전체주문	2	주문 취소	0	주문 임시저장	0	주문서 접수(대접수)/확인중	0(0)/0
주문서 오류	0	Set up작업중/컨펌 수령중	0/0	교정자문의 검토중	0/0	Set up 컨펌 대기	1
Set up 검토완료	0	장치 설계 진행중	0	가공중	0	발송완료	1


주문서 접수

주문취소

D:O Ortho
NAVI
DIO Web Site
Order Manual 2 Ver. KOR
Full Digital Ortho Solution



DIO Ortho Work Flow 1

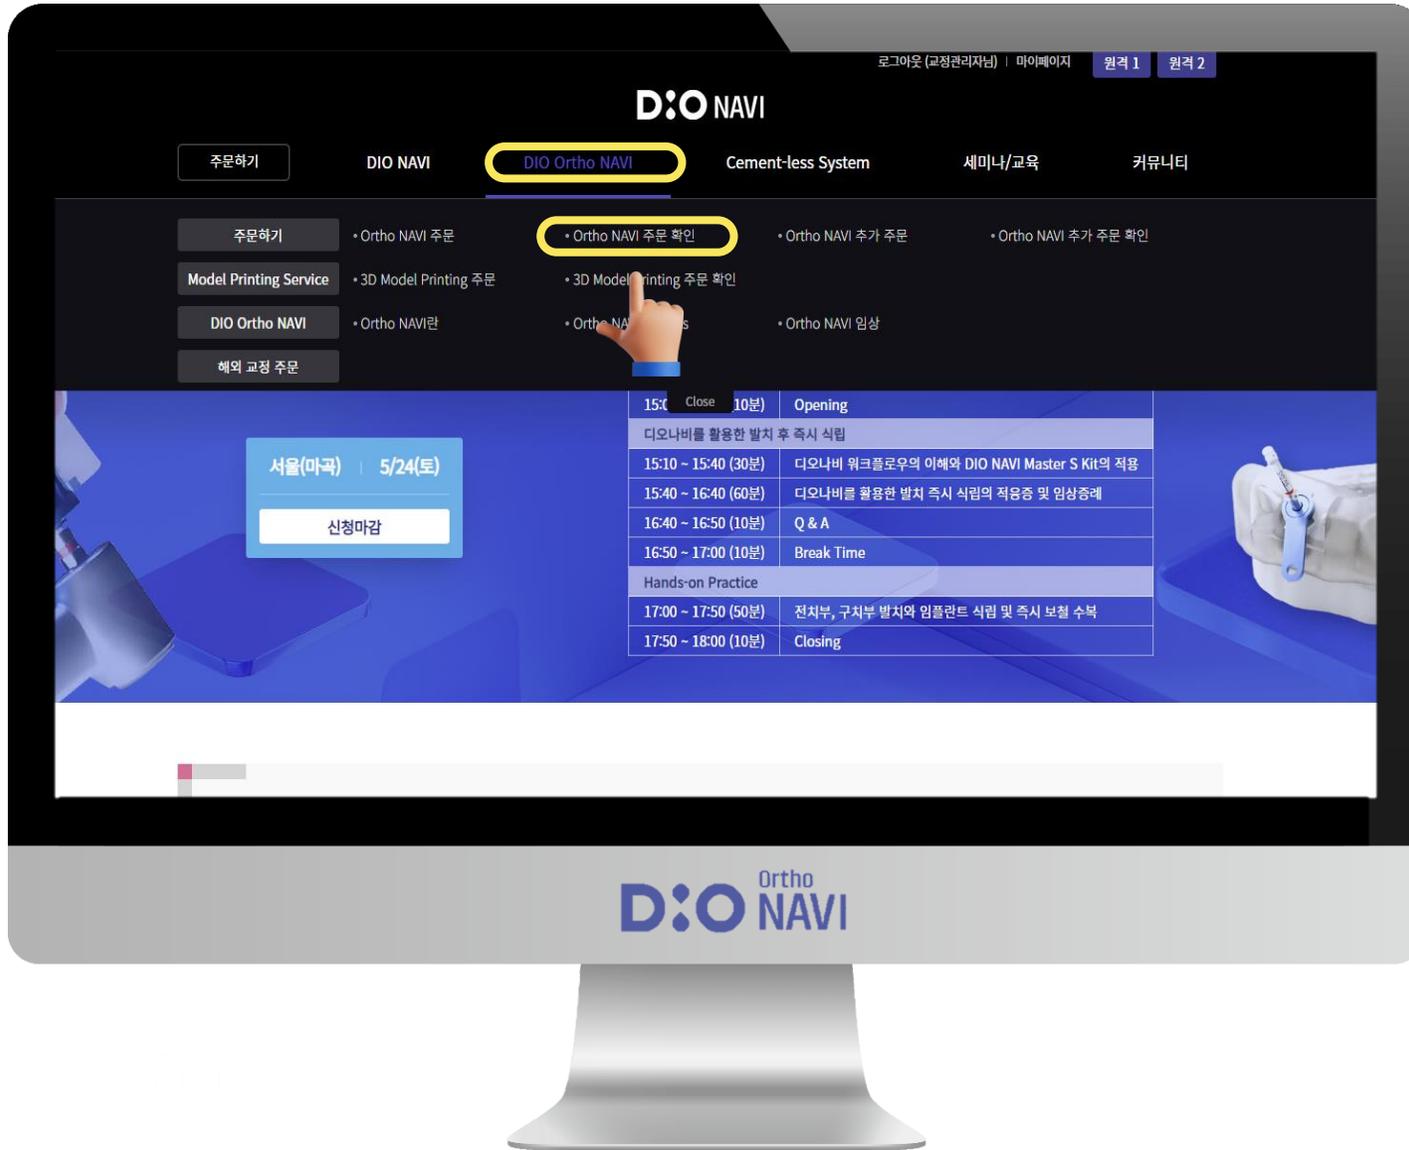

DIO Ortho NAVI 주문확인

- Ortho NAVI. 주문
 - 처음 진단요청(주문) 하는 경우
- Ortho NAVI. 주문확인
 - 주문 요청한 환자의 진행 상태를 확인 하는 경우
- DIO Ortho NAVI. 추가 주문
 - 주문한 환자의 추가적인 요청이 필요한 경우
- Ortho NAVI. 추가 주문 확인
 - 추가 요청한 환자의 진행 상태를 확인 하는 경우

DIO Ortho Work Flow 2

+ 3박 4일

(주말 및 공휴일 제외)

+ 6박 7일

(주말 및 공휴일 제외)


주문확인




주문서 접수




Set up 작업 중




컨펌 대기 중



장치 설계 진행 중



장치 설계 진행 중



발송완료



주문서 임시저장



*주문 접수가 안된 상태

주문서 오류수정



*주문 정보가 잘못된 경우

주문 취소

* 현 시점 부터 주문취소 불가/ 수수료 발생

→ 공식적인 단계

→ 치과에서 확인이 필요한 단계

DIO Ortho Work Flow 2

Step1

DIO Ortho navi. 주문 확인 홈 > DIO Ortho navi. > 주문하기 > DIO Ortho navi. 주문 확인

전체주문	주문 취소	주문 임시저장	주문서 접수
주문서 접수 확인(배정대상)	주문서 오류 / 수정	Set up 작업중	교정자문의 검토중
교정자문의 검토완료	의뢰병원 Set up 컨펌 대기중	의뢰병원 Set up 수정요청	의뢰병원 Set up 컨펌 완료
장치 설계 진행중	가공중	발송완료	

Step2

[주문취소](#)

주문번호	접수일	접수확인일	컨펌완료일	치과(기공소)명	환자명	범위/장치	치료 약궁	진행상태	담당 플래너	상세보기
<input type="checkbox"/> 32051				보스톤치과-용인시아인용	김라현	전체교정	하악 하악: 순측		미지정	

Step3

	<input type="text" value="파일 선택 선택된 파일 없음"/>
	<input type="text" value="파일 선택 선택된 파일 없음"/>
쿠폰 코드	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
주문서 접수	주문서 임시저장 주문취소

01 주문서 임시저장

*주문서를 임시로 저장한 경우

1. 주문서 임시저장 단계 클릭
2. <돋보기> 아이콘 클릭!
3. 페이지 가장 아래의 <주문서 접수> 클릭 ▶ “접수 완료”

DIO Ortho Work Flow 2

Step1

DIO Ortho navi. 주문 확인 홈 > DIO Ortho navi. > 주문하기 > DIO Ortho navi. 주문 확인

전체주문	주문 취소	주문 임시저장	주문서 접수
주문서 접수 확인(배정대상)	주문서 오류 / 수정 1	Set up 작업중	교정자문의 검토중
교정자문의 검토완료	의뢰병원 Set up 컨펌 대기중	의뢰병원 Set up 수정요청	의뢰병원 Set up 컨펌 완료
장치 설계 진행중	가공중	발송완료	

Step2

진행 상태를 변경하세요 ▼

주문번호	접수일	접수확인일	컨펌완료일	치과(기공소)명	환자명	범위/장치	치료 약궁	진행상태	담당 플래너	상세보기
<input type="checkbox"/> 32038	2024-02-21			경희대학교	김가은	Teen Teen	양악 상악: 투명교정 하악: 투명교정		미지정	

Step3

04 오류정보 수정/재접수 내역

Ortho navi.팀 오류 수정 의견	2023-03-28 테스트
주문서 재접수	주문취소

02 주문서 오류 수정

*주문서 오류가 발생했을 경우

1. 상세보기의 <돋보기> 아이콘 클릭
2. 4번 <Ortho navi. 팀 의견 > 내용 확인
3. 주문서 오류내용 확인 후 수정
4. <주문서 재접수> 클릭

DIO Ortho Work Flow 3

Step1

DIO Ortho navi. 주문 확인 홈 > DIO Ortho navi. > 주문하기 > DIO Ortho navi. 주문 확인

전체주문	2	주문 취소	0	주문 임시저장	0	주문서 접수(재접수)/확인중	0(0)/0
주문서 오류	0	Set up작업중/컨펌 수정중	0/0	교정자문의 검토중	0/0	Set up 컨펌 대기	1
Set up 검토완료	0	장치 설계 진행중	0	가공중	0	발송완료	1

Step2

주문번호	접수일	주문접수 확인일	컨펌완료일	치과명	환자명	범위/장치	치료 약궁	진행상태	상태 메시지	상세보기
35680	2024-11-07	2024-11-07		IT전략	서울테스트	Comprehensive Comprehensive	양악 상악: 투명교정 하악: 투명교정	Setup 컨펌대기	[컨펌요청]Set up 컨펌 대기중	


컨펌 내역	<input checked="" type="radio"/> [SetUp.1st (2024-11-07)]
3D Viewer	View [다운로드]
3D Simulation	View [다운로드]
3D Attachment	보기 [다운로드]
IPR Guide	상악 IPR Guide 김성현 투명교정 상악 IPR Guide.pdf 하악 IPR Guide 김성현 투명교정 하악 IPR Guide.pdf
Ortho navi.팀 의견	Click
Ortho navi Fee	Click

03 Set up 컨펌 대기


1. <돋보기> 아이콘 클릭
2. 페이지 아래 <Set-up 컨펌대기> 내용 확인
3. Set up 파일 / 내용 확인 사항
 - 3D Viewer 교정 전/후 비교 [View](#)
 - 3D Simulation [View](#)
 - 3D Attachment [View](#)

DIO Ortho Work Flow 3


Step3

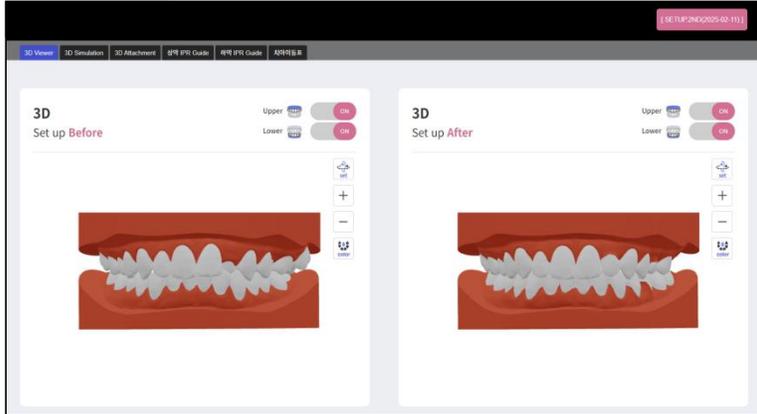

<3D Viewer>

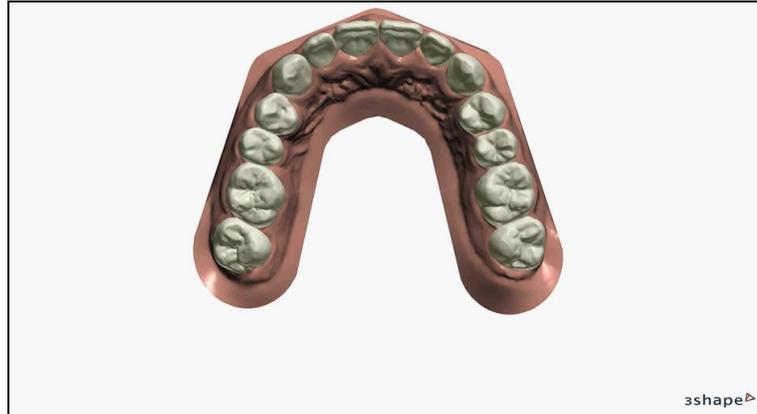

<3D Simulation>

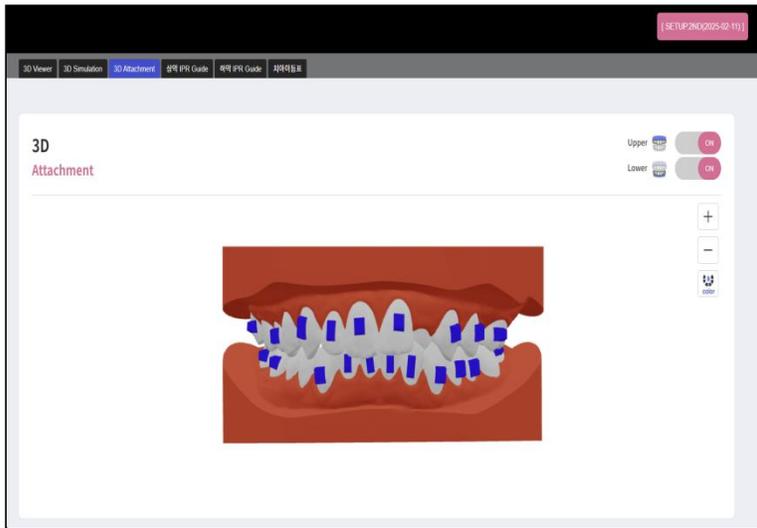

<3D Attachment>



<IPR Guide>



03-1 Set up 컨펌 대기

1. 3D Viewer 교정 전/후 비교 [View](#)
 2. 3D Simulation [View](#)
 3. 3D Attachment [View](#)
 4. IPR Guide (Download)
- * 모든 파일은 다운로드 가능

DIO Ortho Work Flow 3

Step4

3D Simulation	View [다운로드]
3D Attachment	보기 🔍 [다운로드]
IPR Guide	상악 IPR Guide 김성현 투영교정 상악 IPR Guide.pdf 📄
	하악 IPR Guide 김성현 투영교정 하악 IPR Guide.pdf 📄
Ortho navi.팀 의견	Click 👉
병원 의견	Click 👉



DIO Ortho navi.팀 의견

병원의견

2024-11-07
업로드 된 set up 파일은 최종 set up입니다.

<특이사항>
Upper 최초 계획 : 40 Step
Upper 이번 장치 : 15 Step (1Step - 10일)
Upper 누적 장치 : Step 01 ~ Step 15
Gap Retainer 1장 제작
#17 - #15, #13 - #27 attach 부착

Lower 최초 계획 : 50 Step
Lower 이번 장치 : 15 Step (1Step - 10일)
Lower 누적 장치 : Step 01 ~ Step 15
Gap Retainer 1장 제작
#47 - #42, #31 - #35 attach 부착



2024-07-03
딥바이트 해소를 위해 셋업된 모습에서 상하악이 좀더 합입되었으면 좋겠습니다 그리고 수평피개도 더 감소되도록 상악 IPR해서 좀더 안으로 넣었으면 좋겠어요

3747은 추가 버튼 없이 업라이트가 잘될지 확인 필요합니다

2024-06-13
오버바이트 감소를 위해 전치부바이트 추가원해요

03-2 Set up 컨펌 대기

1. DIO Ortho navi.팀 의견 [Click](#)

- 제품에 대한 기본정보 (필독)
- 진단내용 및 첨부파일 첨부

2. 병원의견 [Click](#)

- 교정Set-up 수정에 대한 History 확인 가능
- Set-up 및 제작에 대한 지시사항 및 주의사항 기록

***치과의견에 대해 Set-up 수정은 1day 걸림**

DIO Ortho Work Flow 3

Step1

07 Set up 수정/컨펌시 작성해주세요

컨펌선택	선택 <small>※ 컨펌 완료시 선택해주세요.</small>
병원의견	선택 <small>병원의견을 작성해주세요.</small> [SetUp.1st (2024-11-07)]
첨부파일	파일 선택 <small>선택된 파일 없음</small>

← Set up 수정 요청 Set up 컨펌 완료 → 주문취소



Step2



04 Set up 수정요청 및 컨펌완료

- 1. 컨펌선택** ※컨펌 완료 시 선택해주세요.
 - 수정 or 컨펌 하는 Set-up 종류 선택
- 2. 병원의견**
 - 수정하고 싶은 내용기입 또는 제작 시 요청사항 기입
- 3. 주문서 결정**

Set-up 수정 요청 Set-up 컨펌 완료


*Set-up 컨펌완료 이후에는 취소 시 전체비용의 50% 청구

D:O Ortho
NAVI
DIO Web Site
Order Manual 3 Ver. KOR
Full Digital Ortho Solution




DIO Ortho Work Flow



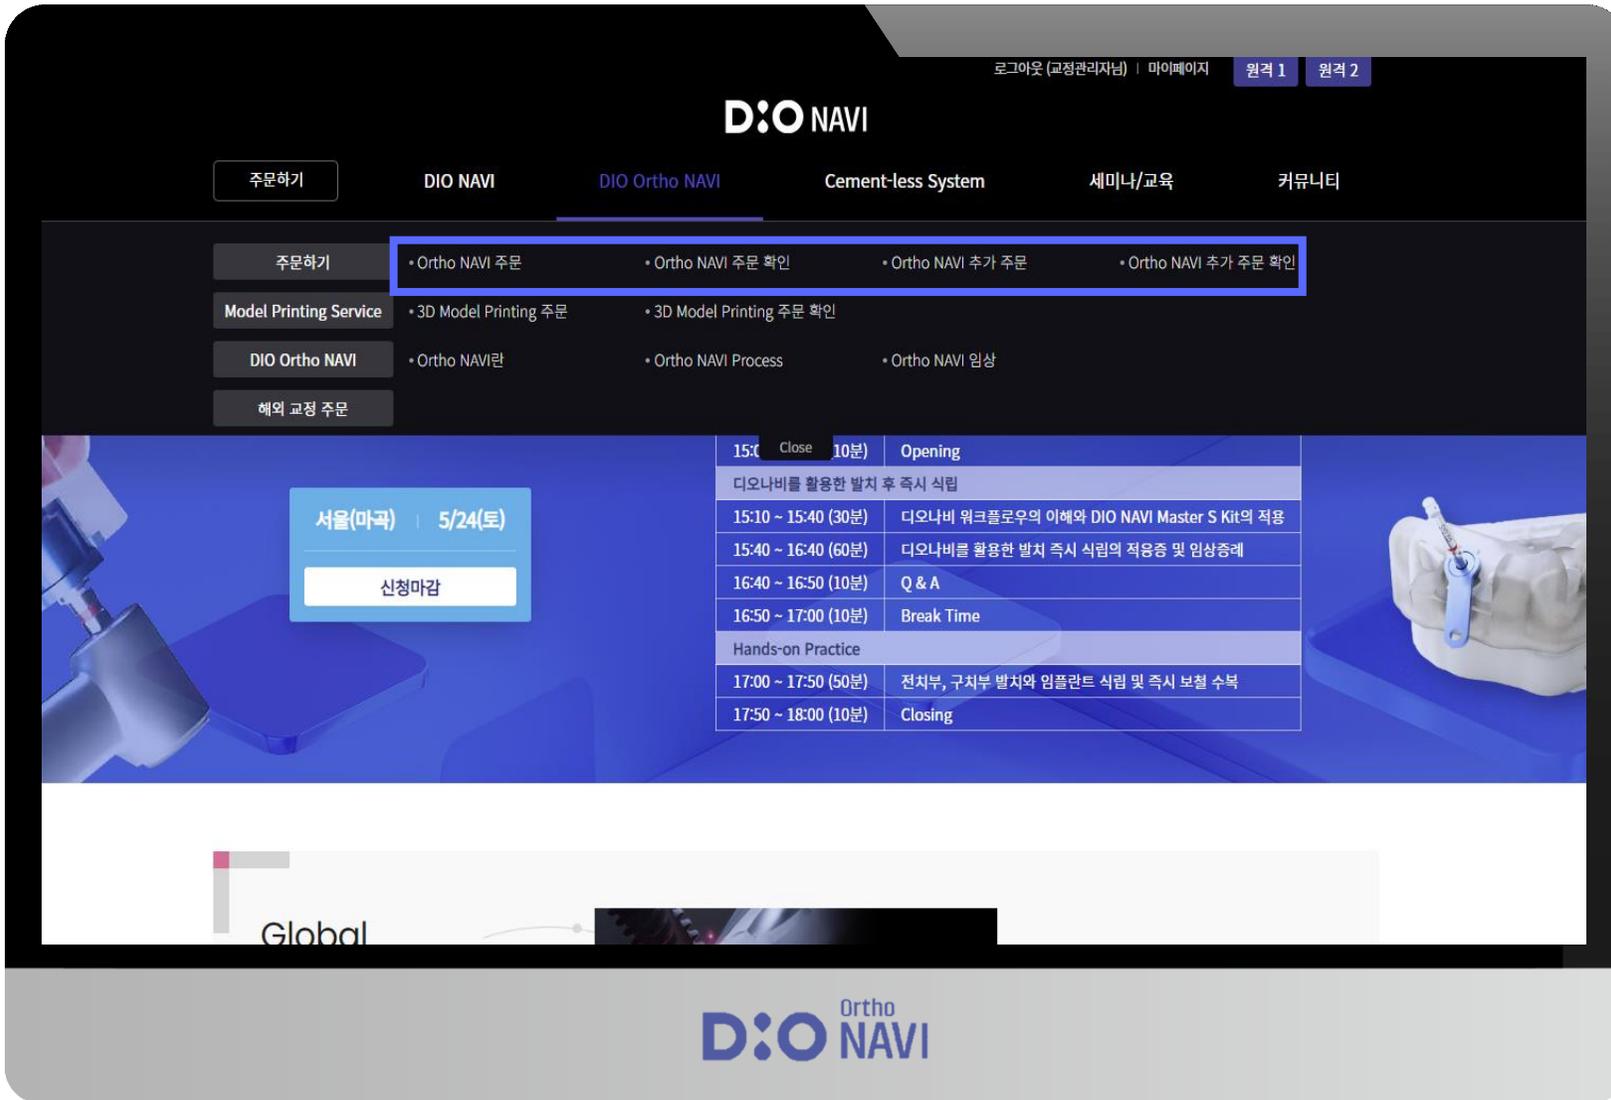

DIO Ortho NAVI 주문확인

- Ortho NAVI. 주문
 - 처음 진단요청(주문) 하는 경우
- Ortho NAVI. 주문 확인
 - 주문 요청한 환자의 진행 상태를 확인 하는 경우
- Ortho NAVI. 추가 주문
 - 주문한 환자의 추가적인 요청이 필요한 경우
- Ortho NAVI. 추가 주문 확인
 - 추가 요청한 환자의 진행 상태를 확인 하는 경우

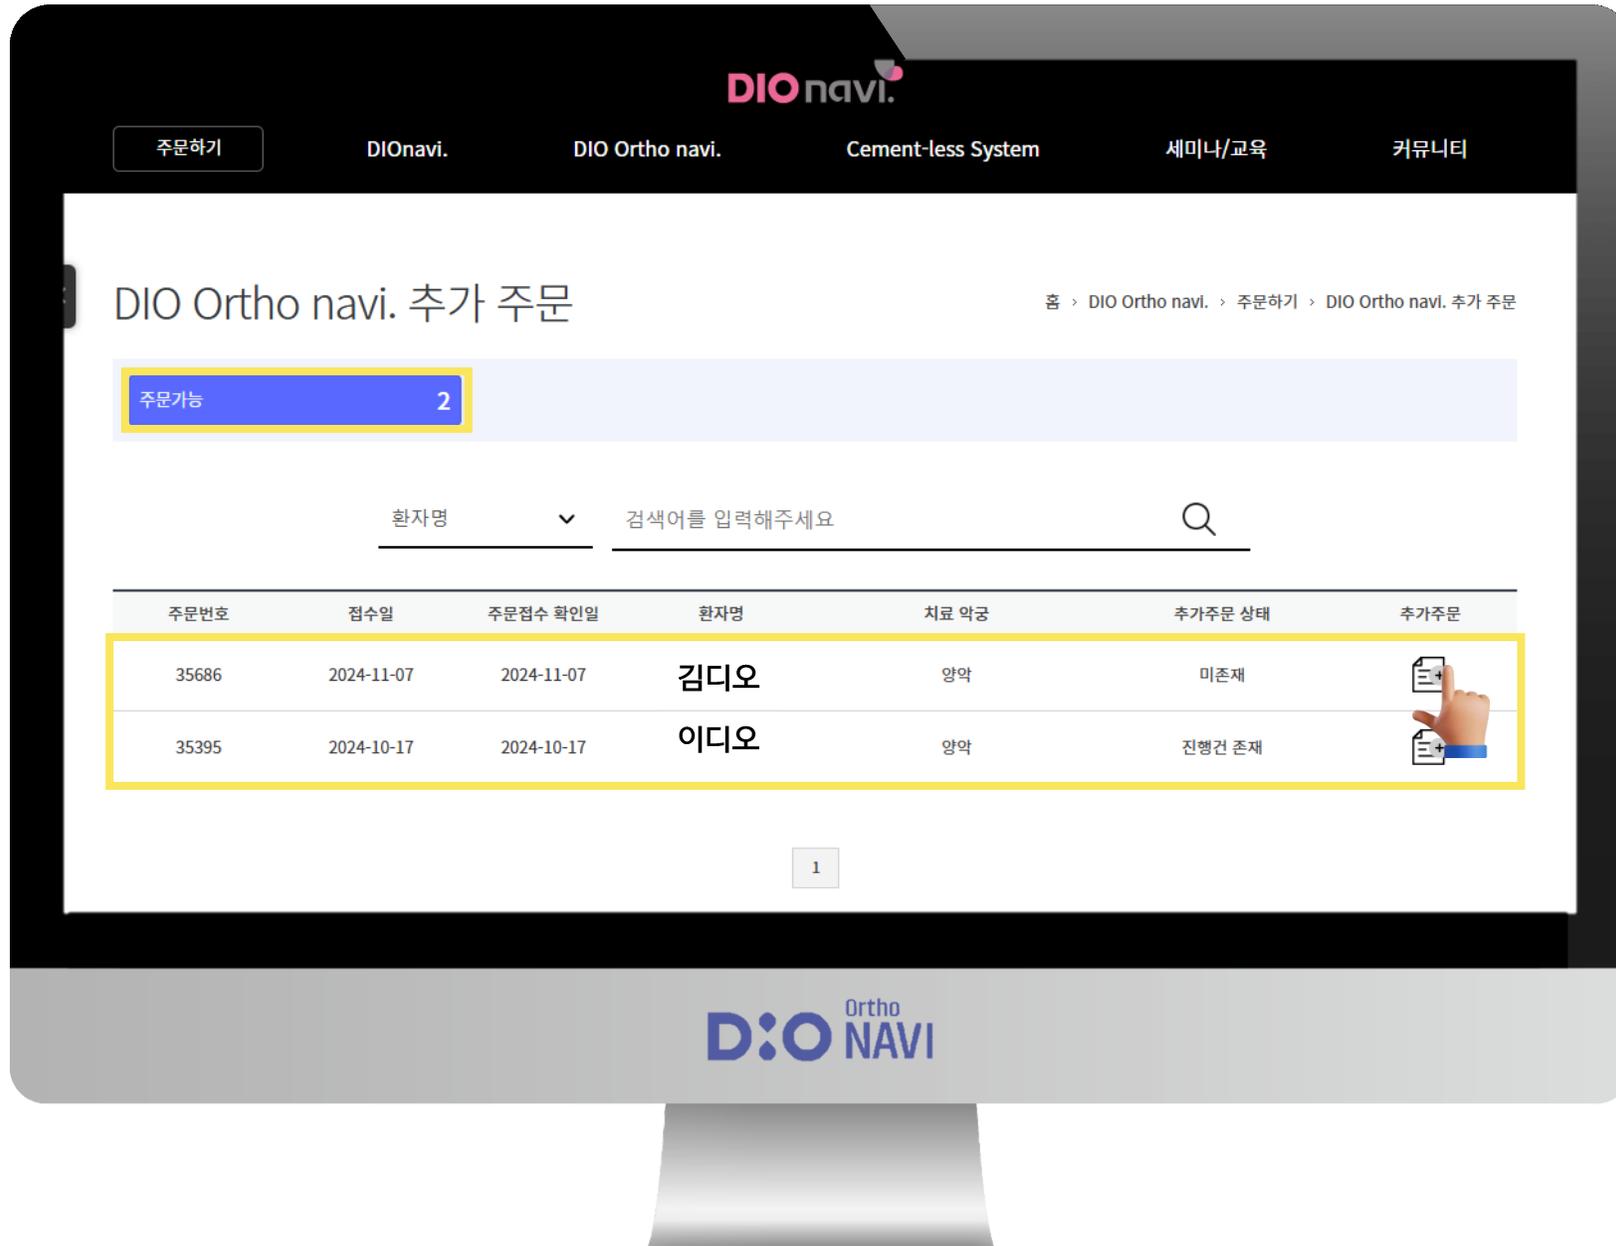

추가주문서 작성

- Ortho NAVI. 추가 주문 클릭
- 추가 주문은 제품이 제작된 환자만 보입니다.
- 주문하고자 하는 환자명 확인 후
〈돌보기〉아이콘 클릭

01/02 치과정보 / 환자정보

- 치과정보 : 최초주문 정보가 자동 업로드
- 주문담당자 변경되는 경우 입력가능

주문 담당 연락처/이메일 *		
담당자변경	1234	1234545
담당자2-2	2222	2222
담당자3-2	3333	3333

* 담당자 정보로 SMS와 이메일이 발송됩니다. 정확한 정보를 입력해주세요.

- 환자 기본정보 : 최초주문 정보가 자동 업로드

작성시에 주의해주세요!

1 디오 Ortho navi. 주문서 Chrome에서 사용하시길 권장드립니다.

01 치과정보

* 표시는 필수 입력항목입니다.

치과명/기공소(실) *	IT전략	
배송지 정보 *	IT전략: (612020) 부산 해운대구 우동	
	612020	부산 해운대구 우동
	배송메세지를 입력해주세요.	
회원 기본정보 연락처	test	전화번호 1234
	1	전화번호 이메일
	1	전화번호 이메일
	<small>* 해당 항목은 마이페이지 > 정보수정 에서 변경이 가능합니다. * 휴대폰번호/이메일 정보 변경 시, 진행중인 주문건에 대해서도 변경된 정보로 SMS와 이메일이 발송됩니다.</small>	
주문 담당 연락처/이메일 *	담당자1-2	1111 1111
	담당자2-2	2222 2222
	담당자3-2	3333 3333
	<small>* 담당자 정보로 SMS와 이메일이 발송됩니다. 정확한 정보를 입력해주세요.</small>	
영업담당자 연락처/이메일 *	서정권	010-5316-8953 sjk@dlo.co.kr

02 환자기본정보

* 표시는 필수 입력항목입니다.

환자 이름 *	서울테스트	
생년월일 *	1999-10-10	환자 성별 <input type="radio"/> 남자 <input checked="" type="radio"/> 여자

03 주문정보

* 표시는 필수 입력항목입니다.

주문 접수 번호	35686
치료 악궁 *	<input checked="" type="checkbox"/> 양악 <input type="checkbox"/> 상악 <input type="checkbox"/> 하악
장치 종류 *	<input checked="" type="radio"/>  순측 <input type="radio"/> 설측 <input checked="" type="radio"/> 투명교정 <input type="radio"/>  순측 <input type="radio"/> 설측 <input checked="" type="radio"/> 투명교정
투명장치 Stage*	<input checked="" type="radio"/>  Express <input type="radio"/> Lite <input type="radio"/> Enough <input checked="" type="radio"/> Comprehensive <input type="radio"/> Teen <input type="radio"/> 유지장치 <input type="radio"/> 기타 <input type="radio"/>  Express <input type="radio"/> Lite <input type="radio"/> Enough <input checked="" type="radio"/> Comprehensive <input type="radio"/> Teen <input type="radio"/> 유지장치 <input type="radio"/> 기타
투명장치 Type	Type 1 Flat Edge view
주문 제품 *	<input type="checkbox"/> 추가 투명장치 <input type="checkbox"/> 재셋업(브라켓) <input type="checkbox"/> 브라켓 <input type="checkbox"/> Wire <input type="checkbox"/> Bite Guide <input type="checkbox"/> 기타
요청 사항	요청사항을 기재 부탁드립니다.
첨부 파일	파일 선택 선택된 파일 없음
배송 일자	

03 주문정보

- 주문정보 : 최초주문 정보 자동 업로드
 - 치료 악궁 / 장치종류 / 투명장치 Stage 변경 불가
- 투명장치 Type * (최초 주문정보)

Type 1 Flat Edge



Type 2 Gingiva Cutting Edge



주문 제품 *	<input checked="" type="checkbox"/> 추가 투명장치 <input type="checkbox"/> 재셋업(브라켓) <input type="checkbox"/> 브라켓 <input type="checkbox"/> Wire <input type="checkbox"/> Bite Guide <input type="checkbox"/> 기타
Scan File *	<input type="radio"/> Trios Scan <input type="radio"/> Medit Scan <input type="radio"/> 석고모델 <input checked="" type="radio"/> 기타
Scan File Upload (기타일 경우) *	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">파일 선택</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">선택된 파일 없음</div> <p><small>※ 압축파일 또는 STL 파일만 업로드가 가능하며 파일은 1개만 업로드가 가능합니다.</small></p>
장치 구분 *	<p>상악 : <input checked="" type="checkbox"/> 유지 목적 <input type="checkbox"/> 치료 목적 <input type="checkbox"/> 재제작 <input type="checkbox"/> 해당 없음 <input type="checkbox"/> GAP Retainer</p> <p>하악 : <input type="checkbox"/> 유지 목적 <input type="checkbox"/> 치료 목적 <input type="checkbox"/> 재제작 <input type="checkbox"/> 해당 없음 <input type="checkbox"/> GAP Retainer</p>
요청 사항	요청사항을 기재 부탁드립니다.
첨부 파일	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">파일 선택</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">선택된 파일 없음</div>
배송 일자	※ 배송 날짜는 주문일로부터 3박4일 소요됩니다. (주말,공휴일 제외)



03 주문정보

- **주문 제품 ***
 추가 투명장치 = Refinement
- **Scan File ***
 Trios Scan Medit Scan 석고모델 기타
 석고모델 선택 시 Scan 대비 +2일

석고 모델 주문시 확인하세요!

교정 석고 모델 주문 시 주의하세요!

교정 Scan 금액: 유 2021년 1월부터 디오·네비 통합결제 석고모델에 대한 Scan Fee(10,000원)가 적용됩니다. 유 석고 모델 보관 기간은 3개월입니다. 이후에는 석고 모델이 폐기될 수 있습니다.

제작기간: 석고 모델 주문 접수 시 Trios 대비 +2일 소요 (주문 및 공급일 제외) 이후 받은 진행 일로부터 제작기간 2박 3일

1일	2일	3일	4일	5일	6일	7일	8일	9일
			제작기간					
		Trios	접수/제작/배송 및 확인	제작/배송	제작/배송	제작/배송	제작/배송	제작/배송
		석고모델	접수/제작/배송 및 확인	제작/배송	제작/배송	제작/배송	제작/배송	제작/배송

배송(제품 출고): 진행 확인 날로부터 +3일 (진행 확인이 늦어지면 배송일이 늦어집니다.)

제품 수령: 발송일 +2일 이후

석고 모델 발송시: 디오 분사용 석고 모델 발송 시, **포장 박스 외관에 교정용** 문구 표시 후 발송해주시요. 표시가 없는 석고 모델은 택배 분리가 어려워 작업시간이 지연될 수 있습니다.

[배치]
 부산: 부산광역시 해운대구 센텀서로66 디오 빌딩 6층 교정팀(문서)
 서울: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 44 디오 9층 901호 디오 교정팀

빠른 작업을 위해 '교정용' 문구 표시 부탁드립니다.

○ 기타 선택 시 Scan File 업로드 가능

Scan File Upload (기타일 경우) *

파일 선택

선택된 파일 없음

※ 압축파일 또는 STL 파일만 업로드가 가능하며 파일은 1개만 업로드가 가능합니다.

- 스캔 파일 압축 시 (상악/하악/교합) 3가지 파일 필수로 포함 되어야 합니다.

주문 제품 *	<input checked="" type="checkbox"/> 추가 투명장치 <input type="checkbox"/> 재셋업(브라켓) <input type="checkbox"/> 브라켓 <input type="checkbox"/> Wire <input type="checkbox"/> Bite Guide <input type="checkbox"/> 기타
Scan File *	<input type="radio"/> Trilos Scan <input type="radio"/> Medit Scan <input type="radio"/> 석고모델 <input checked="" type="radio"/> 기타
Scan File Upload (기타일 경우) *	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음 ※ 압축파일 또는 STL 파일만 업로드가 가능하며 파일은 1개만 업로드가 가능합니다.
장치 구분 *	<p>상악 : <input checked="" type="checkbox"/> 유지 목적 <input type="checkbox"/> 치료 목적 <input type="checkbox"/> 재제작 <input type="checkbox"/> 해당 없음 <input type="checkbox"/> GAP Retainer</p> <p>하악 : <input type="checkbox"/> 유지 목적 <input type="checkbox"/> 치료 목적 <input type="checkbox"/> 재제작 <input type="checkbox"/> 해당 없음 <input type="checkbox"/> GAP Retainer</p>
요청 사항	요청사항을 기재 부탁드립니다.
첨부 파일	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음
배송 일자	※ 배송 날짜는 주문일로부터 3박4일 소요됩니다. (주말,공휴일 제외)

03 주문정보

- **장치 구분 ***

- 유지 목적 (교정종료 후 현 상태 유지를 위한 투명유지장치)
- 치료 목적 (다음Step 치료장치 제작을 위한 투명치료장치)
- 재제작 (장치분실 및 파손으로 인한 재제작)
- 해당 없음
- GAP Retainer (다음 장치가 전달되기 전까지 현재상태를 유지하는장치)

- **요청 사항 ***

요청사항을 기재 부탁드립니다.
(다음 장치 제작 시 요청사항 및 지시사항을 자세하게 기입)




03 주문정보

- **치료목적 선택 시 구내사진 첨부 ***
 1. 상악 교합면
 2. 하악 교합면
 3. 정면
 4. 교합 시 좌측 측면
 5. 교합 시 우측 측면
 6. 2cm 개구 시 정면 (과개교합의 경우 필수)

- **공간 확보 / 폐쇄 ***

○ 모든 공간 폐쇄 남아있는 공간 부위에 체크 후 기입 해 주세요.



○ 일부 공간 유지 일부 공간을 유지 할 부위를 체크 해 주세요.




○ 일부 공간 확보 공간 확보 부위 체크 후 mm수 기입 해 주세요.



○ DIO plan에 따름 치료계획 또는 특이사항 기입 해 주세요.

▶ **치료계획** Ex1) #14,24 Implant / Ex2) #13-#23 br.

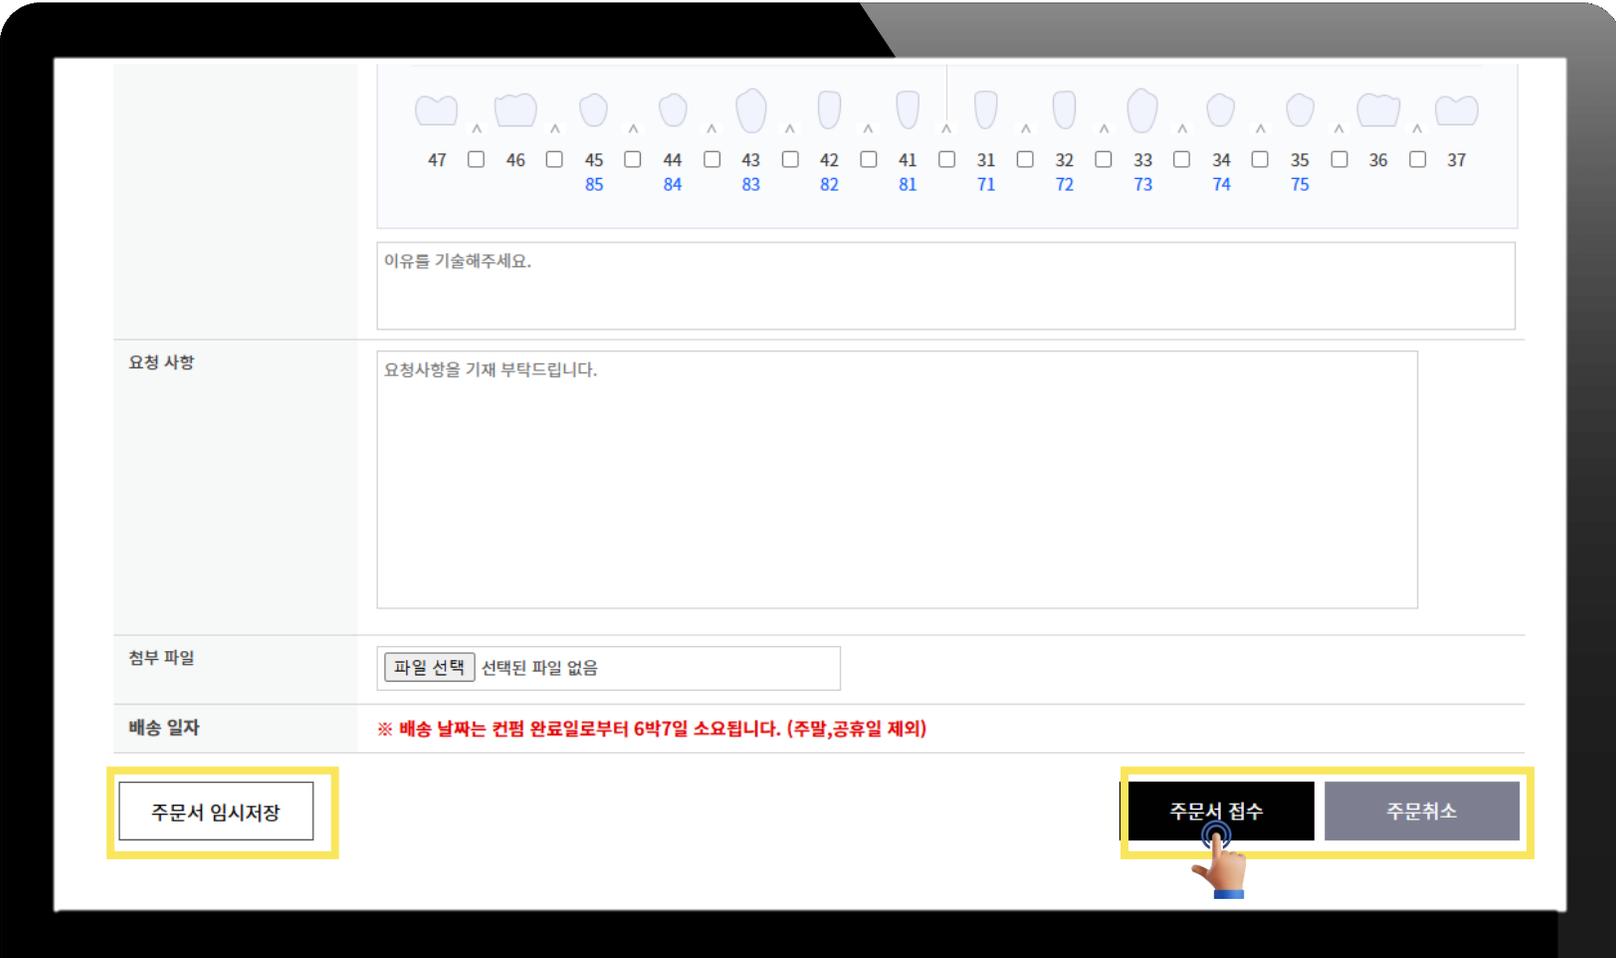

04 추가장치 접수

주문서 임시저장

주문서 임시저장 할 경우 “주문 임시저장” 에서 확인 가능합니다.

DIO Ortho navi. 추가 주문 확인

홈 > DIO Ortho navi. > 주문하기 > DIO Ortho navi. 추가 주문 확인

현재 주문	12	주문 취소	1	주문 임시저장	1	주문서 접수(대입수)	0(0)
주문서 오류	0	Set up착입중/인원 수명중	0/0	Set up인원 대기중/완료	1/0	장치 설계 진행중	0
가공 및 발송 준비중	0	발송완료	11				

주문서 접수

주문 취소

D:O Ortho
NAVI
DIO Web Site
Order Manual 4 Ver. KOR
Full Digital Ortho Solution



DIO Ortho Work Flow 1



DIO Ortho NAVI 주문확인

- Ortho NAVI. 주문
 - 처음 진단요청(주문) 하는 경우
- Ortho NAVI. 주문확인
 - 주문 요청한 환자의 진행 상태를 확인 하는 경우
- DIO Ortho NAVI. 추가 주문
 - 주문한 환자의 추가적인 요청이 필요한 경우
- Ortho NAVI. 추가 주문 확인
 - 추가 요청한 환자의 진행 상태를 확인 하는 경우

DIO Ortho Work Flow 2

Step1

DIO Ortho navi. 추가 주문 확인 홈 > DIO Ortho navi. > 주문하기 > DIO Ortho navi. 추가 주문 확인

전체 주문	12	주문 취소	1	주문 임시저장	0	주문서 접수(재접수)	0(0)
주문서 오류	1	Set up작업중/컨펌 수정중	0/0	Set up컨펌 대기중/완료	0/0	장치 설계 진행중	0
가공 및 발송 준비중	0	송완료	11				

Step2

35687 2024-11-07 서울테스트 양약 상약: 치료 목적 하약: 치료 목적 **주문서 오류** [주문서 오류]주문서에 오류가 있습니다. 오류 내용을 확인해주세요.

Step3

04 오류정보 수정/재접수 내역

Ortho navi.팀 오류 수정 의견 2024-11-07
스캔데이터 중첩 오류로 재스캔 요청드립니다.

주문서 재접수 주문취소

01 추가주문서 오류 수정

*주문서 오류가 발생했을 경우

- 주문서 자료 및 내용이 부족한 경우
- Scan 및 석고가 부정확한 경우

1. 상세보기의<돋보기> 아이콘 클릭
2. 4번 <Ortho NAVI. 팀 의견 > 내용 확인
3. 주문서 오류내용 확인 후 수정
4. <주문서 재접수> 클릭

DIO Ortho Work Flow 3

Step1

DIO Ortho navi. 추가 주문 확인 홈 > DIO Ortho navi. > 주문하기 > DIO Ortho navi. 추가 주문 확인

전체 주문	12	주문 취소	1	주문 임시저장	0	주문서 접수(재접수)	0(0)
주문서 오류	0	Set up작업중/컨펌 수정중	0/0	Set up컨펌 대기중/완료	1/0	장치 설계 진행중	0
가공 및 발송 준비중	0	발송완료	11				



Step2

35687	2024-11-07	2024-11-07	서울테스트	양약 상약: 치료 목적 하약: 치료 목적	Setup 컨펌대기	Set up컨펌 대기중입니다.	
-------	------------	------------	-------	------------------------------	---------------	------------------	--



Step3

컨펌 내역	[SetUp.1st (2024-11-07)]
3D Viewer	보기 [다운로드]
IPR Guide	상약 IPR Guide 최지민 투명교정CS 하약 IPR Guide.pdf 하약 IPR Guide 최지민 투명교정CS 하약 IPR Guide.pdf
Ortho navi. 팀 의견	Click
Ortho navi Fee	Click

02 Refinement Set-up 확인

- Set-up 컨펌 대기 / 완료 클릭
- <돌보기> 아이콘 클릭
- 페이지 아래 < Set-up 컨펌대기 > 내용 확인
- Set up 파일 / 내용 확인 사항
 - 3D Viewer [View](#)
 - IPR Guide
 - DIO Ortho NAVI.팀 의견 [Click](#)
 - Ortho NAVIFee [Click](#)

*추가주문 Set-up에서는 3D Simulation Attachment Viewer 제공 하지 않습니다.

DIO Ortho Work Flow 4

Step4

3D Simulation	View [다운로드]
3D Attachment	보기 [다운로드]
IPR Guide	상악 IPR Guide 김성현 투영교정 상악 IPR Guide.pdf
	하악 IPR Guide 김성현 투영교정 하악 IPR Guide.pdf
Ortho navi.팀 의견	Click
병원 의견	Click

DIO Ortho NAVI.팀 의견

병원의견



2024-11-07
업로드 된 set up 파일은 최종 set up입니다.

<특이사항>
Upper 최초 계획 : 40 Step
Upper 이번 장치 : 15 Step (1Step - 10일)
Upper 누적 장치 : Step 01 ~ Step 15
Gap Retainer 1장 제작
#17 - #15, #13 - #27 attach 부착

Lower 최초 계획 : 50 Step
Lower 이번 장치 : 15 Step (1Step - 10일)
Lower 누적 장치 : Step 01 ~ Step 15
Gap Retainer 1장 제작
#47 - #42, #31 - #35 attach 부착

2024-07-03
딤바이트 해소를 위해 셋업된 모습에서 상하악이 좀더 합입되었으면 좋겠습니다 그리고 수평피개도 더 감소되도록 상악 IPR해서 좀더 안으로 넣었으면 좋겠어요

3747은 추가 버튼 없이 업라이트가 잘릴지 확인 필요합니다

2024-06-13
오버바이트 감소를 위해 전치부바이트 추가원해요

02-1 Refinement Set-up 확인

- DIO Ortho navi.팀 의견
 - 제품에 대한 기본정보 (필독)
 - 진단내용 및 추가파일 첨부
 - 병원 의견
 - 교정Set-up 수정에 대한 History 확인 가능
 - Set-up 및 제작에 대한 지시사항 및 주의사항 기록
- *치과의견에 대해 Set-up 수정은 1day 걸림**

DIO Ortho Work Flow 5

Step1

07 Set up 수정/컨펌시 작성해주세요

컨펌선택	선택 <small>※ 컨펌 완료시 선택해주세요.</small>
병원의견	선택 <small>병원의견을 작성해주세요.</small> [SetUp.1st (2024-11-07)]
첨부파일	파일 선택 <small>선택된 파일 없음</small>

← Set up 수정 요청 Set up 컨펌 완료 → 주문취소



Step2



04 Set up 수정요청 및 컨펌완료

- 1. 컨펌선택 ※컨펌 완료 시 선택해주세요.
 - 수정 or 컨펌 하는 Set-up 종류 선택
- 2. 병원의견
 - 수정하고 싶은 내용기입 또는 제작 시 요청사항 기입
- 3. 주문서 결정

Set-up 수정 요청 Set-up 컨펌 완료

*Set-up 컨펌완료 이후에는 취소 시 전체비용의 50% 청구

